


Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CODICE DI GARA ANAC 8096887

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 06/05/2022


PREMESSO CHE:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 23/04/2021 è stata indetta "Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria" il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GU/S S82 - 210749-2021-IT del 28/04/2021 e sulla GURI (V° Serie Speciale) N. 52 del 07/05/2021:
 - da espletare mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n.50/2016 suddivisa in 27 lotti;
 - da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - della durata di mesi 48 mesi;
 - per un importo totale per l'intera durata pari ad € 6.822.848,00;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 30/04/2021 è stata disposta la rettifica della gara con conseguente variazione dei valori stimati regionali dell'intera procedura: il valore economico stimato per 12 mesi è stato rettificato ad € 1.705.712,00 (IVA esclusa); il valore economico stimato per 48 mesi è stato rettificato ad € 6.822.848,00 (IVA esclusa);
- entro i termini di scadenza per l'invio dell'istanza di partecipazione, hanno presentato istanza n. 16 Operatori Economici;
- in data 16/08/2021 il RUP, come da verbali del 09/06/2021, del 14/06/2021 e del 16/08/2021, dopo avere esaminato le istanze di partecipazione e la documentazione amministrativa connessa alle stesse, ha disposto con provvedimento del 16/08/2021

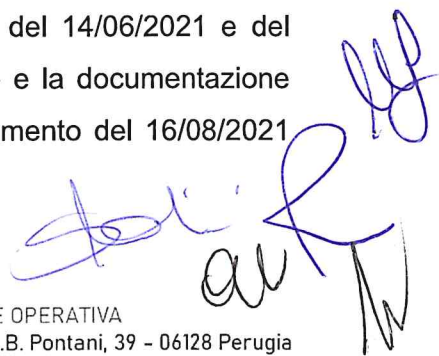

l'ammissione per n. 16 Operatori Economici i cui nominativi non vengono divulgati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), almeno fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

- con Determinazione dell'Amministratore di PuntoZero s.c.ar.l. del 10/02/2022 è stato approvato il fascicolo di gara inviato alle ditte ammesse in data 14/02/2022 tramite piattaforma telematica;
- entro il termine assegnato sono stati riscontrati i chiarimenti da parte delle Ditte e che le risposte ai quesiti nonché ogni altro chiarimento spontaneo formulato dalla stazione Appaltante mediante la funzione "chiarimenti" all'interno della piattaforma di eprocurement sono acquisiti quale parte integrante a tutti gli effetti della documentazione di gara;
- in data 16/03/2022 il RUP con comunicazione pubblicata nella sezione chiarimenti ha provveduto all'aggiornamento dell'importo del lotto n. 6 che risultava erroneamente riportato in piattaforma per un valore annuale pari ad euro 6.000,00 come risultante dalla documentazione di gara, con conseguente aggiornamento della scheda di offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma; ha precisato inoltre che per i concorrenti che avevano già depositato offerta comprensiva del lotto n.6 recante l'errato importo a base d'asta di euro 24.000 (data l'impossibilità di revocare l'offerta già depositata), in caso di ravvisata incertezza da parte della stazione appaltante circa l'esatto valore dell'offerta economica presentata, terrà conto anche di quanto inserito nel dettaglio di offerta economica per il solo lotto n.6 in discussione;
- la scadenza delle offerte è stata prevista, da ultimo, tassativamente per il giorno 16/03/2022 ore 20.00 e la apertura delle buste amministrative è stata prevista in data 17/03/2022 9.30;
- nelle giornate del 18/03/2022, 24/03/2022 si sono tenute le sedute di apertura delle buste amministrative, nel corso delle quali sono state disposte le ammissioni delle ditte la cui documentazione amministrativa è risultata regolarmente trasmessa e alla ammissione con riserva delle ditte nei confronti delle quali è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio;

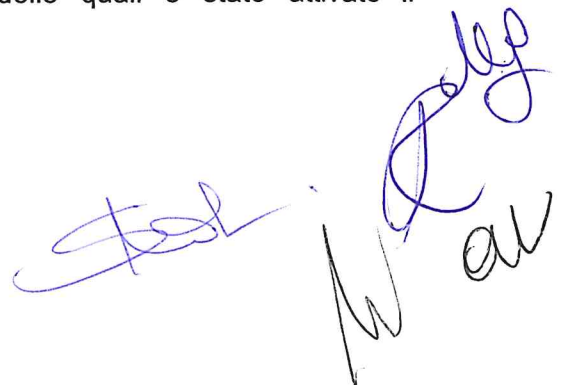

- nella seduta del 14/04/2022 si è proceduto alla verifica della documentazione di soccorso istruttorio e all'esito il RUP ha disposto il provvedimento di ammissione ed esclusione complessivamente riepilogando, per le seguenti ditte concorrenti, :

OPERATORE ECONOMICO	STATUS	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	AMMESSO	1 - 8
ANTONIO PELLECCIA SRL	AMMESSO	8
B.BRAUN MILANO SPA	ESCLUSO	
BARD SRL	AMMESSO	11 - 12 - 20 - 27
BOSTON SCIENTIFIC SPA	AMMESSO	5 - 6 - 9 - 10 - 25
COOK ITALIA SRL	AMMESSO	5 - 6
ENDOVASCULAR SERVICE SRL	AMMESSO	25
GADA ITALIA SPA	AMMESSO	7
H.D. HEALTH DEFENCE SPA	ESCLUSO	
MEDTRONIC ITALIA SPA	AMMESSO	12 - 13 - 15
NEOVASC SRL	AMMESSO	5 - 18 - 26
NEW TECH SRL	AMMESSO	6 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26
OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ESCLUSO	
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	AMMESSO	12 - 17
VIOLATECH SRL	AMMESSO	9 - 12 - 19 - 20
W.I.GORE & ASSOCIATI	AMMESSO	2 - 3 - 4 - 24 - 25

- con determina dell'Amministratore Unico del 06/04/2022, è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

- Dott.ssa Lydia Romano– Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro;
- Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro.

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante.


TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 06/05/2020 alle ore 9.15 si è riunita per la prima seduta la Commissione giudicatrice regolarmente costituita unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, alla presenza della Dott.ssa Valentina Alabastri in qualità di collaboratrice del RUP.

Prima di procedere con le attività programmate per la seduta odierna si dà atto che per mero errore di trascrizione la tabella riportata a fine verbale della seduta del 14/04/2022 e replicata sopra non conteneva per la Ditta ABBOTT l'indicazione del lotto n.9 di partecipazione, per il quale invece risultava correttamente depositata tutta la documentazione amministrativa in tutte le precedenti fasi di gara, come rilevato nei verbali delle sedute e come risulta da un'ulteriore verifica a conferma in data odierna. Pertanto la mancata trascrizione in tabella del riferimento al lotto n.9 della ditta ABBOTT è da riferire ad un mero errore di trascrizione.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market, che pur non consentendo agli OO.EE. di potersi collegare "in diretta", tuttavia assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato tenendo conto anche della opportunità di mantenere distanziamento sociale a tutela della salute pubblica.

La Commissione, a partire dalle ore 9.15, provvede con le attività previste al par. 16 della Lettera di invito in particolare procede a verificare il deposito telematico della documentazione tecnica inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione presentata; a tal fine alle ore 9.43 apre virtualmente le offerte tecniche.



Tutte le seguenti ditte hanno superato positivamente la verifica circa il regolare e completo deposito telematico della documentazione tecnica richiesta di cui al par.10 lettera di invito e relativa firma digitale:


- ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
- ANTONIO PELLECCIA SRL
- B.BRAUN MILANO SPA
- BARD SRL
- BOSTON SCIENTIFIC SPA
- COOK ITALIA SRL
- ENDOVASCULAR SERVICE SRL
- GADA ITALIA SPA
- H.D. HEALTH DEFENCE SPA
- MEDTRONIC ITALIA SPA
- NEOVASC SRL
- NEW TECH SRL
- OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
- VIOLATECH SRL
- W.I.GORE & ASSOCIATI

La Commissione dà atto che la ditta **SEDA SPA CON SOCIO UNICO** ha presentato la cartella di documentazione tecnica per il solo lotto n.12 all'interno della quale non risulta depositato nessuno studio clinico contravvenendo così le disposizioni di cui al par. 10 lett. c) della lettera di invito previsto a pena di esclusione. Inoltre la stessa ditta non ha depositato nessuna cartella e nessun documento di offerta tecnica per il lotto n.17 violando così l'intero contenuto del par. 10.

Per tali motivazioni la Ditta **SEDA SPA CON SOCIO UNICO non viene ammessa** al prosieguo della gara per i lotti n.12 e n.17.

Si dà altresì atto che la ditta **VIOLATECH** ha predisposto documentazione per il lotto n.6 per il quale non aveva formulato istanza e non aveva depositato documentazione amministrativa pertanto non viene presa in considerazione per tale lotto.

La Commissione procede ad esaminare la documentazione tecnica nel merito al fine di verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e, solo in caso di esito positivo

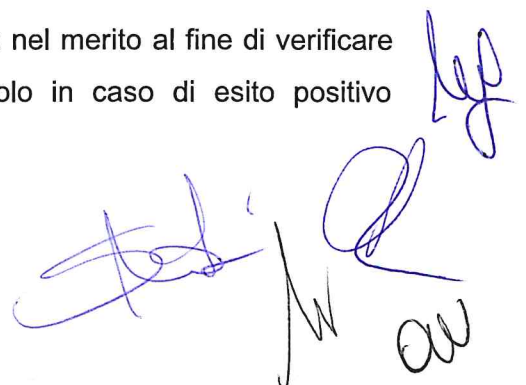

LOTTO N. 1: Stent autoespandibile in fili di nitinol intrecciati
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent autoespandibile;
in fili di nitinol intrecciati per piccoli vasi a basso profilo;
compatibile con guida 0,018" e 0,014";
diametri da 4.5 a 7.5 mm;
lunghezze fino a 200 mm.
Sub lotto: lunghezze da 20 a 200 mm.

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
x
x
x
x
x
x

			ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL		
REQUISITI PREFERENZIALI					
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	0		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
3. Precisione durante il rilascio	15	15	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
5. Navigabilità	15	15	1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

VALUTAZIONE DISCREZIONALE

OTTIMA	1
PIU' CHE ADEGUATA	0,8
ADEGUATA	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATA	0,4
SCARSAMENTE ADEGUATA	0,2
INADEGUATA	0

LOTTO N. 2: Stent in e Ptf e acciaio premontato su pallone di Ptf e legame in eparina
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent in ePtf e acciaio;
premontato su pallone di Ptf;
legame in eparina;
range di diametri da 5 mm a 11 mm con possibilità di sovradilatazione fino a 16 mm.
Sub lotti: Lunghezze 15/20 mm circa
Sub lotti: Lunghezze 30/40 mm circa
Sub lotti: Lunghezze 60/70 mm circa

W.L.GORE & ASSOCIATI	
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

REQUISITI PREFERENZIALI		W.L.GORE & ASSOCIATI			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	8	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO			68,00		

VALUTAZIONE DISCREZIONALE	
OTTIMA	1
PIU' CHE ADEGUATA	0,8
ADEGUATA	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATA	0,4
SCARSAMENTE ADEGUATA	0,2
INADEGUATA	0

LOTTO N. 3: Endoprotesi in nitinolo ricoperta in ePTFE composta da un filo di nitinolo unico. Marker radiopachi
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
endoprotesi in nitinolo;
ricoperta in ePTFE;
composta da un filo di nitinolo unico, senza punti di connessione;
superficie interna ricoperta di eparina;
marker radiopachi con lunghezze da 2,5 a 25 cm.
Sub lotti: Lunghezze 2,5-5 cm
Sub lotti: Lunghezze 10 cm
Sub lotti: Lunghezze 15 cm
Sub lotti: Lunghezze 25 cm.

W.L.GORE & ASSOCIATI	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

W.L.GORE & ASSOCIATI					
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX
			0	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			0	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

VALUTAZIONE DISCREZIONALE

OTTIMA	1
PIU' CHE ADEGUATA	0,8
ADEGUATA	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATA	0,4
SCARSAMENTE ADEGUATA	0,2
INADEGUATA	0

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one on the right, and several initials at the bottom right.

procederà alla valutazione dei requisiti preferenziali, tenendo conto che, come previsto al par. 12.3 della Lettera di invito, le offerte tecniche che non conseguiranno un punteggio almeno pari o superiore a **36 punti** non saranno ammesse al prosieguo della gara (soglia di sbarramento).

LOTTO N. 1: Stent autoespandibile in fili di nitinol intrecciati

- **ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti preferenziali, con il seguente esito finale: **60,00**.

LOTTO N. 2: Stent in e Ptf e acciaio premontato su pallone di Ptf e legame in eparina

- **W.L.GORE & ASSOCIATI**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti preferenziali, con il seguente esito finale: **68,00**.






LOTTO N.3 : Endoprotesi in nitinolo ricoperta in ePTFE composta da un filo di nitinolo unico. Marker radiopachi

- **W.L.GORE & ASSOCIATI**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti preferenziali, con il seguente esito finale: **60,00**

Alle ore 13.13 si sospendono le attività e si rinvia per il prosieguo ad altra seduta.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dott.ssa Lydia Romano– con funzioni di Presidente _____ 
- Dott.ssa Serena Natalini – in qualità di membro _____ 
- Dott.ssa Benedetta Enrico – in qualità di membro _____ 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante _____ 
- Dott.ssa Valentina Alabastri- collaboratore e testimone _____ 


Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CODICE DI GARA ANAC 8096887

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 27/05/2022

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 23/04/2021 è stata indetta "Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria" il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GU/S S82 - 210749-2021-IT del 28/04/2021 e sulla GURI (V° Serie Speciale) N. 52 del 07/05/2021:
 - da espletare mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n.50/2016 suddivisa in 27 lotti;
 - da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - della durata di mesi 48 mesi;
 - per un importo totale per l'intera durata pari ad € 6.822.848,00;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 30/04/2021 è stata disposta la rettifica della gara con conseguente variazione dei valori stimati regionali dell'intera procedura: il valore economico stimato per 12 mesi è stato rettificato ad € 1.705.712,00 (IVA esclusa); il valore economico stimato per 48 mesi è stato rettificato ad € 6.822.848,00 (IVA esclusa);
- entro i termini di scadenza per l'invio dell'istanza di partecipazione, hanno presentato istanza n. 16 Operatori Economici;
- in data 16/08/2021 il RUP, come da verbali del 09/06/2021, del 14/06/2021 e del 16/08/2021, dopo avere esaminato le istanze di partecipazione e la documentazione amministrativa connessa alle stesse, ha disposto con provvedimento del 16/08/2021 l'ammissione per n. 16 Operatori Economici i cui nominativi non vengono divulgati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), almeno fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- con Determinazione dell'Amministratore di PuntoZero s.c.ar.l. del 10/02/2022 è stato

approvato il fascicolo di gara inviato alle ditte ammesse in data 14/02/2022 tramite piattaforma telematica;

- entro il termine assegnato sono stati riscontrati i chiarimenti da parte delle Ditte e che le risposte ai quesiti nonché ogni altro chiarimento spontaneo formulato dalla stazione Appaltante mediante la funzione "chiarimenti" all'interno della piattaforma di eprocurement sono acquisiti quale parte integrante a tutti gli effetti della documentazione di gara;
- in data 16/03/2022 il RUP con comunicazione pubblicata nella sezione chiarimenti ha provveduto all'aggiornamento dell'importo del lotto n. 6 che risultava erroneamente riportato in piattaforma per un valore annuale pari ad euro 6.000,00 come risultante dalla documentazione di gara, con conseguente aggiornamento della scheda di offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma; ha precisato inoltre che per i concorrenti che avevano già depositato offerta comprensiva del lotto n.6 recante l'errato importo a base d'asta di euro 24.000 (data l'impossibilità di revocare l'offerta già depositata), in caso di ravvisata incertezza da parte della stazione appaltante circa l'esatto valore dell'offerta economica presentata, terrà conto anche di quanto inserito nel dettaglio di offerta economica per il solo lotto n.6 in discussione;
- la scadenza delle offerte è stata prevista, da ultimo, tassativamente per il giorno 16/03/2022 ore 20.00 e la apertura delle buste amministrative è stata prevista in data 17/03/2022 9.30;
- nelle giornate del 18/03/2022, 24/03/2022 si sono tenute le sedute di apertura delle buste amministrative, nel corso delle quali sono state disposte le ammissioni delle ditte la cui documentazione amministrativa è risultata regolarmente trasmessa e alla ammissione con riserva delle ditte nei confronti delle quali è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio;
- nella seduta del 14/04/2022 si è proceduto alla verifica della documentazione di soccorso istruttorio e all'esito il RUP ha disposto il provvedimento di ammissione ed esclusione complessivamente riepilogando, per le seguenti ditte concorrenti, :

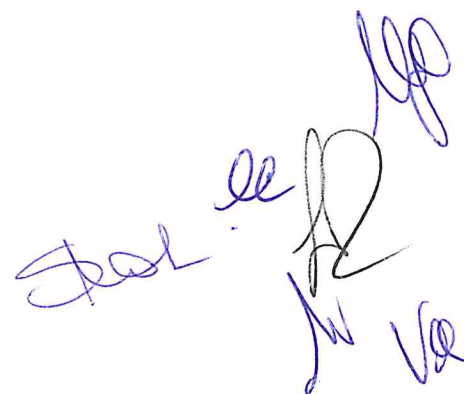

OPERATORE ECONOMICO	STATUS	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	AMMESSO	1 - 8
ANTONIO PELLECCIA SRL	AMMESSO	8
B.BRAUN MILANO SPA	ESCLUSO	
BARD SRL	AMMESSO	11 - 12 - 20 - 27
BOSTON SCIENTIFIC SPA	AMMESSO	5 - 6 - 9 - 10 - 25
COOK ITALIA SRL	AMMESSO	5 - 6
ENDOVASCULAR SERVICE SRL	AMMESSO	25
GADA ITALIA SPA	AMMESSO	7
H.D. HEALTH DEFENCE SPA	ESCLUSO	
MEDTRONIC ITALIA SPA	AMMESSO	12 - 13 - 15
NEOVASC SRL	AMMESSO	5 - 18 - 26
NEW TECH SRL	AMMESSO	6 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26
OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ESCLUSO	
SEDA SPA CON SOCIO UNICO	AMMESSO	12 - 17
VIOLATECH SRL	AMMESSO	9 - 12 - 19 - 20
W.I.GORE & ASSOCIATI	AMMESSO	2 - 3 - 4 - 24 - 25

- con determina dell'Amministratore Unico del 06/04/2022, è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

-Dott.ssa Lydia Romano– Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente;

- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro;

- Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro.

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante.


- in data 06/05/2022 si è riunita per la prima seduta la Commissione giudicatrice nella sua composizione alla presenza di: Dott.ssa Lydia Romano – Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro; Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro.
- In data 06/05/2022 il RUP dà atto che per mero errore di trascrizione la tabella riportata a fine verbale della seduta del 14/04/2022 e replicata sopra non conteneva per la Ditta ABBOTT l'indicazione del lotto n.9 di partecipazione, per il quale invece risultava correttamente depositata tutta la documentazione amministrativa in tutte le precedenti fasi di gara, come rilevato nei verbali delle sedute e come risulta da un'ulteriore verifica a conferma in data odierna. Pertanto la mancata trascrizione in tabella del riferimento al lotto n.9 della ditta ABBOTT è da riferire ad un mero errore di trascrizione.

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 27/05/2022 alle ore 9.15 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero, la Commissione giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Carolina Cinesi e Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero scarl.

La seduta si svolge, ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte nonché l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, per evitare di lasciare pendenti le valutazioni tra una seduta di gara e l'altra per i lotti con più concorrenti, decide di procedere prioritariamente con i lotti con un unico concorrente.

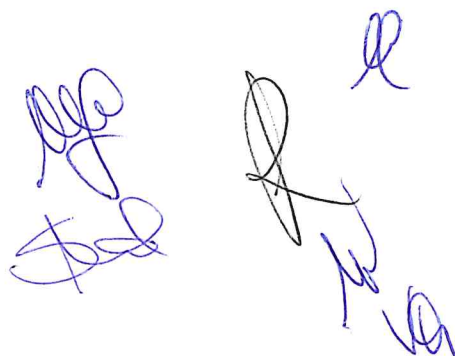

LOTTO N. 4: Endoprotesi in nitinolo ricoperta in ePTFE composta da un filo di nitinolo unico, senza punti di connessione

- **W.L.GORE & ASSOCIATI**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **62,00**.

LOTTO N. 7: Stent carotideo autoespandibile con micromaglia a doppio strato in nitinol a celle chiuse (375-500 micron)

- **GADA ITALIA SPA**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

LOTTO N. 10: Stent carotideo metallico autoespandibile costituito da mono filamenti in lega metallica in Elgiloy intrecciati

- **BOSTON SCIENTIFIC SPA**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

LOTTO N. 11: Endoprotesi autoespandibile in Nitinolo senza accorciamento. Presenza di 5 markers radiopachi

- **BARD SRL**


La Commissione rileva che non sussistono tutti i requisiti tecnici minimi in particolare il prodotto offerto è carente del requisito "*presenza di 5 markers radiopachi (6 per diametri da 10 e 12 mm)*" e non è conforme a quello che prevede "*lunghezza catetere sia 80 che 120cm*".

Conseguentemente il prodotto offerto viene giudicato **NON IDONEO**.

LOTTO N. 13: Stent in acciaio 316L premontato su pallone in nylon minimamente compliant

- **MEDTRONIC ITALIA SPA**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

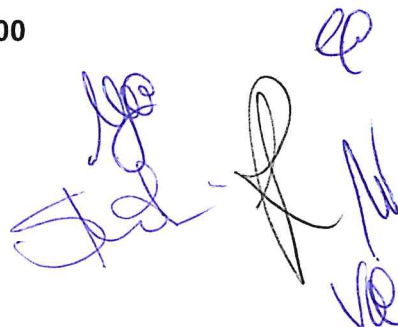

LOTTO N. 15: Stent in Nitinolo autoespandibile a celle aperte, disponibile nella forme cilindrica o rastremata, con forma a collo di bottiglia.

- **MEDTRONIC ITALIA SPA**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

LOTTO N. 16: Stent autoespandibile in Nitinol con sistema di rilascio micrometrico a grilletto, OTW (0.035"), e triassiale, compatibile con introduttore 6F per l'intera gamma di misure. Rivestimento al Carburo.

- **NEW TECH SRL**

La Commissione rileva che non sussistono tutti i requisiti tecnici minimi in particolare il prodotto offerto è carente del requisito *"lunghezze dello stent da 20 a 200 mm"*. Conseguentemente il prodotto offerto viene giudicato **NON IDONEO**.

LOTTO N. 17: Stent autoespandibile in Nitinol con sistema di rilascio è micrometrico a rotella, OTW (0.018") , triassiale compatibile con introduttore 4F. Rivestimento in Carburo di Silicio Amorfo.

- **NEW TECH SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

LOTTO N. 19: Endoprotesi

- **VIOLATECH SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

LOTTO N. 21: Stent periferico autoespandibile composto da una lega di Nitinol che ricopre un anima di Platino. Sistema di rilascio con catetere coassiale di 3.2

- **NEW TECH SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **61,00**

LOTTO N. 22: Stent carotideo auto-espandibile in Nitinol ricoperto da una retina in PET (Polietilene tereftalato)



- **NEW TECH SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

LOTTO N. 24: Endoprotesi vascolari per procedura TIPS auto espandibile, nitinol e PTFE

- **W.L.GORE & ASSOCIATI**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

LOTTO N. 27: Stent Vascolare Ricoperto Autoespandibile in Nitinol, interamente incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE con lume interno impregnato al Carbonio







- **BARD SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

Si allegano al presente verbale le schede riepilogative delle valutazioni svolte dalla Commissione giudicatrice delle offerte tecniche sopra valutate, per costituirne parte integrante e sostanziale .

Alle ore 12.30 la Commissione sospende le attività e rinvia per il prosieguo delle operazioni alla successiva seduta di gara.

Il verbale confermato e sottoscritto viene sottoscritto come segue.

- Dott.ssa Lydia Romano– con funzioni di Presidente 
- Dott.ssa Serena Natalini – in qualità di membro 
- Dott.ssa Benedetta Enrico – in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri- collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Carolina Cinesi- collaboratore e testimone 

REQUISITI PREFERENZIALI		W.I.GORE & ASSOCIATI			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	2	1	4	4
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		62,00			

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'R' and several other illegible marks.

REQUISITI PREFERENZIALI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima
3. Precisione durante il rilascio
4 .Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione
5. Navigabilità
TOTALE PUNTEGGIO

LOTTO N. 10: Stent carotideo metallico autoespandibile costituito da mono filamenti in lega metallica in Elgiloy intrecciati
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent carotideo metallico autoespandibile;
costituito da mono filamenti in lega metallica;
in Elgiloy;
intrecciati in una configurazione tubolare a maglia;
a celle chiuse;
montato su sistema di rilascio coassiale a basso profilo;
monorail su filoguida 0,014";
misure: diametro stent da 5 a 9 mm

BOSTON SCIENTIFIC SPA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IDONEO

			BOSTON SCIENTIFIC SPA		
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			






LOTTO N. 11: Endoprotesi autoespandibile in Nitinolo senza accorciamento. Presenza di 5 markers radiopachi
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent carotideo metallico autoespandibile;
in Nitinolo senza accorciamento;
presenza di 5 markers radiopachi (6 per diametri da 10 e 12 mm);
in Tantalio sia sulla parte prossimale che distale;
disponibile nei diametri 9,10,12,14 mm;
lunghezze 20-30-40-60-80 mm;
con lunghezza catetere sia 80 che 120cm;
tutti i codici sono compatibili con introduttori 6Fr;
sistema di rilascio a semplice pull-back

BARD SRL
X
X
X
NE POSSIEDE 4 MARKER
X
X
X
NON POSSIEDE LA LINGHEZZA 120
X
X
NON IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI			BARD SRL		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	#DIV/0!	#DIV/0!		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	#DIV/0!	#DIV/0!		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4 .Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	#DIV/0!			
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!			

LOTTO N. 13: Stent in acciaio 316L premontato su pallone in nylon minimamente compliant
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent in acciaio 316L;
premontato su pallone in nylon minimamente compliant;
presenta markers radiopachi in Tantalio sullo stent;
posizionati alle due estremità;
diametri da 5 a 10mm;
lunghezze: 12mm (fino ai diametri da 7mm) e 17, 27, 37, 57mm (tutti i diametri);
compatibili con introduttore 6 - (fino al diametro 8mm, lunghezza 57mm) e 7 Fr;

MEDTRONIC ITALIA SPA
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	MEDTRONIC ITALIA SPA				
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4 .Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

REQUISITI PREFERENZIALI	
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	
3. Precisione durante il rilascio	
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	
5. Navigabilità	
TOTALE PUNTEGGIO	

MEDTRONIC ITALIA SPA			
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
0	#DIV/0!	0	0
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
0	#DIV/0!	0	0
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
60,00			

lunghezza Utile 90 e 135 cm.

x

NON IDONEO

TOTALE PUNTEGGIO

#DIV/0!

LOTTO N. 17: Stent autoespandibile in Nitinol con sistema di rilascio è micrometrico a rotella, OTW (0.018") , triassiale compatibile con introduttore 4F. Rivestimento in Carburo di Silicio Amorfo.

REQUISITI MINIMI

Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)

stent autoespandibile;

in Nitinol;

con sistema di rilascio è micrometrico a rotella;

OTW (0.018");

triassiale compatibile con introduttore 4F per l'intera gamma di misure;

rivestimento in Carburo di Silicio Amorfo

strut sottili da 140 micrometri;

lunghezze dello stent da 20 a 200 mm;

con diametri da 4.0 a 7.0 mm;

lunghezza utile 90 e 135 cm.

NEW TECH SRL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IDONEO

NEW TECH SRL

REQUISITI PREFERENZIALI

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate

10

10

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

VAI

VA

VMAX

2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime

8

0

#DIV/0!

0

0

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

VAI

VA

VMAX

2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima

2

0

#DIV/0!

0

0

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

3. Precisione durante il rilascio

15

15

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione

20

20

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

5. Navigabilità

15

15

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

TOTALE PUNTEGGIO

60,00

LOTTO N. 19: Endoprotesi
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
Sub lotto A): endoprotesi in cromo cobalto;
Sub lotto A): ricoperto in ePTFE;
Sub lotto A): premontato su pallone OTW o monorail maglie degli stent ad anelli corrugati con elevata forza radiale;
Sub lotto A): diametri compresi tra 2,5 mm e 10mm;
Sub lotto A): compatibilità con introduttore Max 6 Fr;
Sub lotto B): endoprotesi tubulare;
Sub lotto B): espandibile su pallone semi-compiante
Sub lotto B): premontato su sistema di rilascio OTW o monorail;
Sub lotto B): stent in cromo- cobalto;
Sub lotto B): completamente ricoperto da un unico strato di ePTFE;
Sub lotto B): diametri da 2.5mm a 10mm;
Sub lotto B): disponibilità anche di versione con doppio stent e doppio strato di ePTFE per un'elevata forza radiale e resistenza alla compressione;
Sub lotto B): compatibilità con introduttore max 6F fino al diametro 8mm per la versione monostent;
Sub lotto B): compatibilità con guide 0.014" o 0.035".

VIOLATECH SRL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IDONEO					
VIOLATECH SRL					
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4 .Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

LOTTO N. 21: Stent periferico autoespandibile composto da una lega di Nitinol che ricopre un'anima di Platino. Sistema di rilascio con catetere coassiale di 3.2

REQUISITI MINIMI

Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
 stent periferico autoespandibile;
 composto da una lega di Nitinol che ricopre un'anima di Platino;
 stent con maglia composta da fili di Nitinol intrecciati;
 sistema di rilascio con catetere coassiale di 3.2 French a basso profilo;
 sistema a guida mobile OTW 0.014";
 stent con diametri da 3.0mm a 4.5mm;
 lunghezze da 40 a 60mm

NEW TECH SRL

X
X
X
X
X
X
X
X

IDONEO

NEW TECH SRL

REQUISITI PREFERENZIALI

	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA 1	OTTIMA 1	OTTIMA 1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	8	VAI 1	VA 2	VMAX 2
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI #DIV/0!	VA 0	VMAX 0
3. Precisione durante il rilascio	15	12	ROMANO PIU' CHE ADEGUATA 0,8	ENRICO PIU' CHE ADEGUATA 0,8	NATALINI PIU' CHE ADEGUATA 0,8
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	16	ROMANO PIU' CHE ADEGUATA 0,8	ENRICO PIU' CHE ADEGUATA 0,8	NATALINI PIU' CHE ADEGUATA 0,8
5. Navigabilità	15	15	ROMANO OTTIMA 1	ENRICO OTTIMA 1	NATALINI OTTIMA 1
TOTALE PUNTEGGIO		61,00			

LOTTO N. 22: Stent carotideo auto-espandibile in Nitinol ricoperto da una retina in PET (Polietilene tereftalato)
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent carotideo auto-espandibile;
in Nitinol;
ricoperto da una retina in PET (Polietilene tereftalato);
è composto da un manipolo di rilascio funzionante con tecnica "pullback";
con sistema di ritenzione che annulla il salto in avanti dello Stent al momento del rilascio;
diametri dello Stent da 6 a 10mm;
lunghezza da 20 a 60 mm;
diametro esterno sistema: 6 Fr (2.1 mm);
compatibilità Catetere Guida: 8Fr (2.7 mm);
compatibilità Filo Guida: 0,014"

NEW TECH SRL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
4 .Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

LOTTO N. 24: Endoprotesi vascolari per procedura TIPS auto espandibile, nitinol e PTFE
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
endoprotesi vascolari per procedura TIPS auto espandibile;
nitinol;
PTFE;
parte scoperta per versante portale;
parte coperta per il tramite intraepatico;
lunghezza da 4cm a 8 cm;
diametro 8/10

W.I.GORE & ASSOCIATI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

LOTTO N. 27: Stent Vascolare Ricoperto Autoespandibile in Nitinol, interamente incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE con lume interno impregnato al Carbonio

REQUISITI MINIMI

Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
 stent vascolare ricoperto autoespandibile;
 in Nitinol;
 interamente incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE;
 con lume interno impregnato al Carbonio;
 marker radiopachi in Tantalio su ciascuna estremità dello stent;
 disponibile in versione retta e fletterata (Porzione distale svasata di 3 mm);
 diametri dello stent da 6 a 10 mm;
 lunghezze da 30 a 100 mm;
 sistema di Rilascio Triassiale OTW con guaina esterna di supporto;
 compatibilità con filo guida da 0,035" e introduttore da 8 e 9 Fr a seconda delle dimensioni.

BARD SRL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

IDONEO

BARD SRL


REQUISITI PREFERENZIALI

	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA 1	OTTIMA 1	OTTIMA 1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI #DIV/0!	VA 0	VMAX 0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI #DIV/0!	VA 0	VMAX 0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO OTTIMA 1	ENRICO OTTIMA 1	NATALINI OTTIMA 1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO OTTIMA 1	ENRICO OTTIMA 1	NATALINI OTTIMA 1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO OTTIMA 1	ENRICO OTTIMA 1	NATALINI OTTIMA 1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CODICE DI GARA ANAC 8096887


VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 09/06/2022

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 23/04/2021 è stata indetta "Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria" il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GU/S S82 - 210749-2021-IT del 28/04/2021 e sulla GURI (V° Serie Speciale) N. 52 del 07/05/2021:
 - da espletare mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n.50/2016 suddivisa in 27 lotti;
 - da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - della durata di mesi 48 mesi;
 - per un importo totale per l'intera durata pari ad € 6.822.848,00;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 30/04/2021 è stata disposta la rettifica della gara con conseguente variazione dei valori stimati regionali dell'intera procedura: il valore economico stimato per 12 mesi è stato rettificato ad € 1.705.712,00 (IVA esclusa); il valore economico stimato per 48 mesi è stato rettificato ad € 6.822.848,00 (IVA esclusa);
- entro i termini di scadenza per l'invio dell'istanza di partecipazione, hanno presentato istanza n. 16 Operatori Economici;
- in data 16/08/2021 il RUP, come da verbali del 09/06/2021, del 14/06/2021 e del 16/08/2021, dopo avere esaminato le istanze di partecipazione e la documentazione amministrativa connessa alle stesse, ha disposto con provvedimento del 16/08/2021 l'ammissione per n. 16 Operatori Economici i cui nominativi non vengono divulgati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), almeno fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- con Determinazione dell'Amministratore di PuntoZero s.c.ar.l. del 10/02/2022 è stato

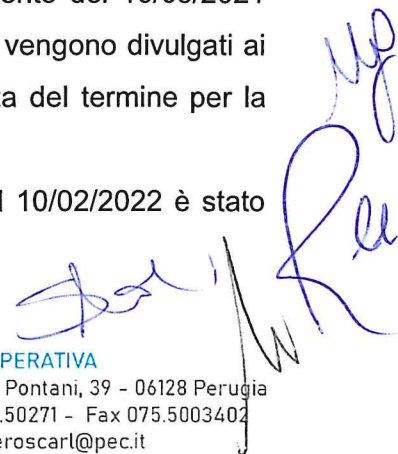

- approvato il fascicolo di gara inviato alle ditte ammesse in data 14/02/2022 tramite piattaforma telematica;
- entro il termine assegnato sono stati riscontrati i chiarimenti da parte delle Ditte e che le risposte ai quesiti nonché ogni altro chiarimento spontaneo formulato dalla stazione Appaltante mediante la funzione "chiarimenti" all'interno della piattaforma di eprocurement sono acquisiti quale parte integrante a tutti gli effetti della documentazione di gara;
 - in data 16/03/2022 il RUP con comunicazione pubblicata nella sezione chiarimenti ha provveduto all'aggiornamento dell'importo del lotto n. 6 che risultava erroneamente riportato in piattaforma per un valore annuale pari ad euro 6.000,00 come risultante dalla documentazione di gara, con conseguente aggiornamento della scheda di offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma; ha precisato inoltre che per i concorrenti che avevano già depositato offerta comprensiva del lotto n.6 recante l'errato importo a base d'asta di euro 24.000 (data l'impossibilità di revocare l'offerta già depositata), in caso di ravvisata incertezza da parte della stazione appaltante circa l'esatto valore dell'offerta economica presentata, terrà conto anche di quanto inserito nel dettaglio di offerta economica per il solo lotto n.6 in discussione;
 - la scadenza delle offerte è stata prevista, da ultimo, tassativamente per il giorno 16/03/2022 ore 20.00 e la apertura delle buste amministrative è stata prevista in data 17/03/2022 9.30;
 - nelle giornate del 18/03/2022, 24/03/2022 si sono tenute le sedute di apertura delle buste amministrative, nel corso delle quali sono state disposte le ammissioni delle ditte la cui documentazione amministrativa è risultata regolarmente trasmessa e alla ammissione con riserva delle ditte nei confronti delle quali è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio;
 - nella seduta del 14/04/2022 si è proceduto alla verifica della documentazione di soccorso istruttorio e all'esito il RUP ha disposto il provvedimento di ammissione ed esclusione;
 - con determina dell'Amministratore Unico del 06/04/2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

-Dott.ssa Lydia Romano– Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente;

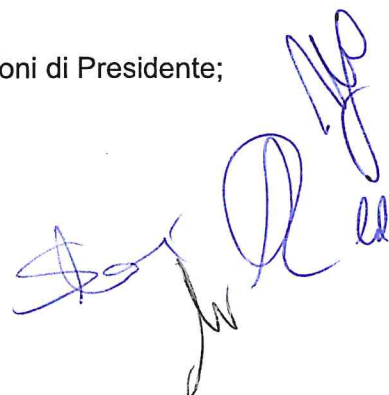

- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro;
- Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro.

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante.

- in data 06/05/2022 si è riunita per la prima seduta la Commissione giudicatrice nella sua composizione alla presenza di: Dott.ssa Lydia Romano– Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro; Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro rilevando in particolare che la ditta SEDA SPA CON SOCIO UNICO non viene ammessa al prosieguo della gara per i lotti n.12 e n.17;
- Inoltre sempre in data 06/05/2022 il RUP dà atto che per mero errore di trascrizione la tabella riportata a fine verbale della seduta del 14/04/2022 e replicata sopra non conteneva per la Ditta ABBOTT l'indicazione del lotto n.9 di partecipazione, per il quale invece risultava correttamente depositata tutta la documentazione amministrativa in tutte le precedenti fasi di gara, come rilevato nei verbali delle relative sedute e come risulta da un'ulteriore verifica a conferma eseguita in data 6/05/2022 durante la seduta di gara. Pertanto la mancata trascrizione in tabella del riferimento al lotto n.9 della ditta ABBOTT è ricondotta ad un mero errore di trascrizione.

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 09/06/2022 alle ore 9.20 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero, la Commissione giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Carolina Cinesi di Puntozero scarl.

La seduta si svolge, ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte nonché l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, per evitare di lasciare pendenti le valutazioni tra una seduta di gara e l'altra per i lotti con più concorrenti, decide di procedere prioritariamente con i lotti con un unico concorrente.

LOTTO N. 5: Stent auto-espandibile in Nitinol a rilascio di farmaco Paclitaxel

- **BOSTON SCIENTIFIC SPA:**

La Commissione constata la carenza di n.3 requisiti minimi richiesti come indicati nella tabella di dettaglio dei punteggi allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso (**Allegato 1**); dà atto altresì che la Ditta ha presentato una dichiarazione di equivalenza in luogo del requisito minimo richiesto della *"presenza di 4 markers d'oro posti su ognuna delle estremità dello stent"* che in ogni caso non è sufficiente a garantire la corrispondenza del prodotto a tutti i requisiti minimi richiesti. Per tali ragioni il prodotto viene giudicato dalla Commissione **NON IDONEO**.

- **COOK ITALIA SRL:**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

- **NEOVASC SRL:**

La Commissione constata la carenza di n.3 requisiti minimi richiesti come riportato nella tabella di dettaglio dei punteggi allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso (**Allegato 1**). Per tali ragioni il prodotto viene giudicato dalla Commissione **NON IDONEO**.

LOTTO N. 6: Stent a celle aperte, premontato su pallone, in acciaio OTW

- **BOSTON SCIENTIFIC SPA:**

La Commissione rileva che nella scheda tecnica non è fatta alcuna menzione circa la sussistenza o meno del requisito richiesto *"pallone semicompiante con doppio markers radiopaco"*. Inoltre viene constatata la carenza di ulteriori n.3 requisiti minimi richiesti come riportato nella tabella di dettaglio dei punteggi allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso (**Allegato 2**). Per tali ragioni il prodotto viene giudicato dalla Commissione **NON IDONEO**.

- **COOK ITALIA SRL:**



La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **50,00**

- **NEW TECH SRL:**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **61,00**

LOTTO N. 8: Stent autoespandibile carotideo in nitinol a tronco conico e tubolare

- **ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

- **ANTONIO PELLECCIA SRL**

La Commissione rileva che con riferimento al requisito minimo "*Lunghezze di 20, 30, 40 mm*" a pag. 3 della scheda tecnica è riportato "*non tutte le misure potrebbero essere commercialmente disponibili. Si prega di contattare l'Azienda o i suoi rappresentanti locali per informazioni dettagliate*" senza indicare esattamente quali misure sono offerte e quali non disponibili. Inoltre viene rilevato che nella documentazione tecnica non viene fornita alcuna indicazione in merito al requisito "*disegno ad anelli corrugati con connessione a ponte*". Pertanto il prodotto è giudicato **NON IDONEO**.

LOTTO N. 9: Stent in nitinol autoespandibile con struttura a corone collegate da ponti

- **ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale:

- **BOSTON SCIENTIFIC SPA:**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi. In particolare la Commissione rileva che con riferimento al requisito migliorativo "*2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime*" la Ditta dichiara nella documentazione tecnica che le lunghezze



aggiuntive 180 e 200 "*lunghezze momentaneamente non disponibili*" pertanto non vengono prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione migliorativa. L'esito valutativo finale è il seguente:

- **VIOLATECH SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale:

LOTTO N. 12: Stent autoespandibile in nitinolo a celle aperte

La Commissione riepiloga che per tale lotto la ditta SEDA SPA CON SOCIO UNICO non era stata ammessa alla fase di valutazione tecnica per i motivi evidenziati nella seduta del 6/05/2022 riferiti nel pedissequo verbale in pari data.

- **BARD SRL:**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **50,00**

- **MEDTRONIC ITALIA SPA:**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

- **SEDA SPA:**

La Commissione rileva che con riferimento al requisito minimo "*catetere di rilascio 5Fr lungo 80 cm, 120 cm oppure 150cm*" la Ditta dichiara nella documentazione tecnica "raccomanda" l'utilizzo di un "introduttore 6 Fr" anziché della misura richiesta 5Fr. Per tale ragione il prodotto offerto è giudicato **NON IDONEO**.

LOTTO N. 18: Stent in CoCr espandibile a palloncino Sistema di rilascio RX compatibile con fili 0.014"

- **NEW TECH SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**

- **NEOVASC SRL**



La Commissione constata la carenza di n.2 requisiti minimi richiesti come indicati nella tabella di dettaglio dei punteggi allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso (**Allegato 3**). Per tali ragioni il prodotto viene giudicato dalla Commissione **NON IDONEO**.

LOTTO N. 20: Stent autoespandibile in nitinolo ricoperto in ePTFE. Struttura dello stent con corone indipendenti disposte con tecnica picco-valle.

- **BARD SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **44,00**

- **VIOLATECH SRL**

La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **62,50**

Si allegano al presente verbale le schede riepilogative delle valutazioni svolte dalla Commissione giudicatrice delle offerte tecniche sopra valutate, per costituirne parte integrante e sostanziale (come peraltro richiamate negli All.1-2-3).

Alle ore 12.30 la Commissione sospende le attività e rinvia per il prosieguo delle operazioni alla successiva seduta di gara.

Il verbale confermato e sottoscritto viene sottoscritto come segue.

- Dott.ssa Lydia Romano– con funzioni di Presidente _____
- Dott.ssa Serena Natalini – in qualità di membro _____
- Dott.ssa Benedetta Enrico – in qualità di membro _____
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante _____
- Dott.ssa Carolina Cinesi- collaboratore e testimone _____


LOTTO N. 6: Stent a cellule aperte, premontato su pallone, in acciaio OTW		BOSTON SCIENTIFIC SPA					COOK ITALIA SRL				NEW TECH SRL			
REQUISITI MINIMI														
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)														
stenti a cellule aperte;		X					X				X			
premontato su pallone;		X					X				X			
in acciaio OTW;		X					X				X			
compatibile con guida da 0.035" e 0.018";		X					X				X			
pallone semicompianto con doppio marker radiopaco;		VERI VERBALE DEL 04/06/2022					X				X			
geografico del palloncino a DOG-BUSINO;		X					X				X			
lunghezza dello shaft: 60 e 135 cm;		NON HA LA LUNGHEZZA 60 CM					X				X			
diametri dello stent: da 3 mm a 10 mm;		NON HA IL DIAMETRO DA 3 MM					X				X			
lunghezza dello stent: da 12 mm a 60 mm;		NON HA LA LUNGHEZZA DA 12 MM					X				X			
		NON ESISTE					ESISTE				ESISTE			
		BOSTON SCIENTIFIC SPA					COOK ITALIA SRL				NEW TECH SRL			
REQUISITI PREFERENZIALI		PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!					4	PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							0,4	0,4	0,4	0,4		1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	#DIV/0!		VAI	VA	VMAX	0	0	0	1	8	1	1	1
				VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma «di diametri: Numero di misure aggiuntive superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	2	#DIV/0!		VAI	VA	VMAX	0	0	0	0	0	0	0	0
				VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!		ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	15	PRU CHE ADEGUATA	PRU CHE ADEGUATA	PRU CHE ADEGUATA
							1	1	1	1		0,8	0,8	0,8
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!		ROMANO	ENRICO	NATALINI	16	PRU CHE ADEGUATA	PRU CHE ADEGUATA	PRU CHE ADEGUATA	16	PRU CHE ADEGUATA	PRU CHE ADEGUATA	PRU CHE ADEGUATA
				ROMANO	ENRICO	NATALINI	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
5. Navigabilità	15	#DIV/0!		ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1	1		1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!					50,00				61,00			



LOTTO N. 8: Stent autoespandibile carotideo in nitinol a tronco conico e tubolare
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent autoespandibile carotideo:
in nitinol;
a tronco conico e tubolare;
monorail;
guida 014";
con disegno ad anelli corrugati e connessioni a ponte;
diametri stent:
distale - prossimale di 6-8 mm e di 7-9mm e 8-10mm;
tubolari da 7 a 10 mm;
Lunghezze di 20, 30, 40 mm;
sistema di rilascio a singola mano

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	ANTONIO PELLECCIA SRL
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	NON DICHIARATO
X	X
X	VEDI VERBALE 09/06/2022
X	VEDI VERBALE 09/06/2022
X	VEDI VERBALE 09/06/2022
X	X
IDONEO	NON IDONEO

		ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL				ANTONIO PELLECCIA SRL			
REQUISITI PREFERENZIALI									
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!			
			1	1	1				
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
	8	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
	2	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3. Precisione durante il rilascio	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!			
			1	1	1				
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!			
			1	1	1				
5. Navigabilità	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!			
			1	1	1				
TOTALE PUNTEGGIO		60,00				#DIV/0!			

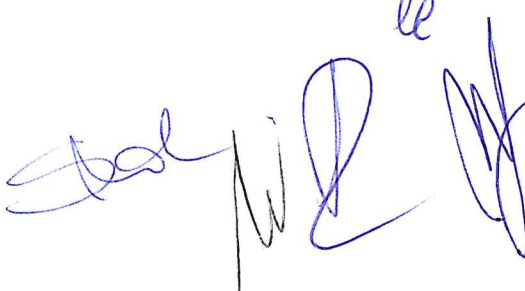le


		BIONEVI			BIONEVI			BIONEVI					
		ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL			BOSTON SCIENTIFIC SPA			VIOLATTECH SRL					
REQUISITI PREFERENZIALI													
1. Studi clinici su malattie scientifiche dedicate	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	6	ADEQUATA	ADEQUATA	ADEQUATA	8	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA
			1	1	1		0,5	0,5	0,5		0,8	0,8	0,8
2A. Gamma di frequenza: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	VAI	VA	VMAX
	8	0	0	0	2	0	0	0	2	8	1	2	2
2B. Gamma di diametro: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quanto indicato nelle caratteristiche di massima	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	VAI	VA	VMAX
	2	0	0	0	2	2	1	2	2	1	0,5	1	2
3. Precisione durante l'utilizzo	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	12	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA	9	ADEQUATA	ADEQUATA	ADEQUATA
			1	1	1		0,8	0,8	0,8		0,6	0,6	0,6
4. Flessibilit�, conformabilit� e resistenza alla compressione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	16	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA	12	ADEQUATA	ADEQUATA	ADEQUATA
			1	1	1		0,8	0,8	0,8		0,6	0,6	0,6
5. Navigabilit�	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSIGLIATO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	12	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA	PIU' CHE ADEQUATA
			1	1	1		1	1	1		0,8	0,8	0,8
TOTALE PUNTEGGIO		60,00				51,00				50,00			



LOTTO N. 12: Strati autosopprimibile in silicio a celle aperte		BARD SRL				MEDTRONIC ITALIA SPA				VIOLATECH SRL			
REQUISITI MINIMI													
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)		X				X				X			
area autosopprimibile:		X				X				X			
inattiva:		X				X				X			
a celle aperte particolarmente adatte per l'ecnia femminile,		X				X				X			
di misure disponibili: 5, 6, 7 e 8 mm.		X				X				X			
compatibile con ultrasuoni SV e guida 0.035°		X				X				X			
sistema di ritenzione dello stiro che assicura l'effetto "jumping",		X				X				X			
cateteri OTV costruito da 3 strati.		X				X				X			
con sistema di rilascio on-demand.		X				X				X			
presenta 4 marker radiopacchi in tantalum posizionati alle due estremità.		X				X				X			
Cateteri di classe SV lungo 90 cm, 120 cm oppure 150cm.		X				X				X			
		PUNTEGGIO				PUNTEGGIO				DICHIARATO INTRODOTTORE RACCOMANDATO E DI NON SE COME RICHIESTO			
		BARD SRL				MEDTRONIC ITALIA SPA				VIOLATECH SRL			
REQUISITI PREFERENZIALI													
		PUNTEGGIO ASSEGNABILE	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	8	PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!			
			0,8	0,8	0,8		1	1	1				
2A. Omnia di lunghezza: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Omnia di diametro: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	2	2	1	2	2	0	0	0	2	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
3. Frequenza durante il rilascio	15	12	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA		#DIV/0!		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA				
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	16	0,8	0,8	0,8	20	1	1	1	#DIV/0!			
			0,8	0,8	0,8		1	1	1				
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA				
5. Navigabilità	15	12	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA	PRP CHE ADEGUATA		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA		#DIV/0!		
			0,8	0,8	0,8		1	1	1				
TOTALE PUNTEGGIO		50,00				60,00				#DIV/0!			




LOTTO N. 18: Stent in CoCr espandibile a palloncino Sistema di rilascio RX compatibile con fili 0.014"
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent in CoCr espandibile;
a palloncino;
sistema di rilascio RX compatibile con fili 0.014";
corona prossimale in Oro;
rivestimento in Carburo di Silicio Amorfo;
lunghezze 12, 15, 19 mm;
compatibilità 4F per diametri 4.5 e 5.00 mm (6.0 e 7.0 mm compatibili 5F);
spessore di strut da 120/140 micrometri;

NEOVASC SRL	NEW TECH SRL
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
NON HA IL DIAMETRO 4.5	X
NON HA LO SPESSORE RICHIESTO DELLA MAGLIA	X

		NEOVASC SRL				NEWTECH SRL			
REQUISITI PREFERENZIALI									
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!				10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
	8	#DIV/0!	#DIV/0!			0	0	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
	2	#DIV/0!	#DIV/0!			0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!				20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	#DIV/0!				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!				60,00			


		LUNGO SRL				LUNGO SRL					
REQUISITI PREFERENZIALI		BARD SRL						VIOLETECH SRL			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI		
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	8	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA		
			0,8	0,8	0,8		1	1	1		
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX		
	8	8	1	4	4	2	0,25	1	4		
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive,superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX		
	2	2	1	4	4	0,5	0,25	1	4		
3. Precisione durante il rilascio	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI		
	15	9	ADEGUATA	ADEGUATA	ADEGUATA	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA		
			0,6	0,6	0,6		1	1	1		
			ROMANO	ENRICO	NATALINI		ROMANO	ENRICO	NATALINI		
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	8	PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA		
			0,4	0,4	0,4		1	1	1		
			ROMANO	ENRICO	NATALINI		ROMANO	ENRICO	NATALINI		
5. Navigabilità	15	9	ADEGUATA	ADEGUATA	ADEGUATA	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA		
			0,6	0,6	0,6		1	1	1		
			ROMANO	ENRICO	NATALINI		ROMANO	ENRICO	NATALINI		
TOTALE PUNTEGGIO		44,00				62,50					



Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CODICE DI GARA ANAC 8096887

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 15/07/2022

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 23/04/2021 è stata indetta "Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria" il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GU/S S82 - 210749-2021-IT del 28/04/2021 e sulla GURI (V° Serie Speciale) N. 52 del 07/05/2021:
 - da espletare mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n.50/2016 suddivisa in 27 lotti;
 - da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - della durata di mesi 48 mesi;
 - per un importo totale per l'intera durata pari ad € 6.822.848,00;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 30/04/2021 è stata disposta la rettifica della gara con conseguente variazione dei valori stimati regionali dell'intera procedura: il valore economico stimato per 12 mesi è stato rettificato ad € 1.705.712,00 (IVA esclusa); il valore economico stimato per 48 mesi è stato rettificato ad € 6.822.848,00 (IVA esclusa);
- entro i termini di scadenza per l'invio dell'istanza di partecipazione, hanno presentato istanza n. 16 Operatori Economici;
- in data 16/08/2021 il RUP, come da verbali del 09/06/2021, del 14/06/2021 e del 16/08/2021, dopo avere esaminato le istanze di partecipazione e la documentazione amministrativa connessa alle stesse, ha disposto con provvedimento del 16/08/2021 l'ammissione per n. 16 Operatori Economici i cui nominativi non vengono divulgati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), almeno fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- con Determinazione dell'Amministratore di PuntoZero s.c.ar.l. del 10/02/2022 è stato

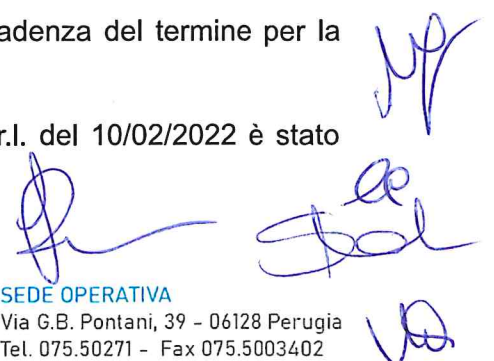

approvato il fascicolo di gara inviato alle ditte ammesse in data 14/02/2022 tramite piattaforma telematica;

- entro il termine assegnato sono stati riscontrati i chiarimenti da parte delle Dite e che le risposte ai quesiti nonché ogni altro chiarimento spontaneo formulato dalla stazione Appaltante mediante la funzione "chiarimenti" all'interno della piattaforma di eprocurement sono acquisiti quale parte integrante a tutti gli effetti della documentazione di gara;
- in data 16/03/2022 il RUP con comunicazione pubblicata nella sezione chiarimenti ha provveduto all'aggiornamento dell'importo del lotto n. 6 che risultava erroneamente riportato in piattaforma per un valore annuale pari ad euro 6.000,00 come risultante dalla documentazione di gara, con conseguente aggiornamento della scheda di offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma; ha precisato inoltre che per i concorrenti che avevano già depositato offerta comprensiva del lotto n.6 recante l'errato importo a base d'asta di euro 24.000 (data l'impossibilità di revocare l'offerta già depositata), in caso di ravvisata incertezza da parte della stazione appaltante circa l'esatto valore dell'offerta economica presentata, terrà conto anche di quanto inserito nel dettaglio di offerta economica per il solo lotto n.6 in discussione;
- la scadenza delle offerte è stata prevista, da ultimo, tassativamente per il giorno 16/03/2022 ore 20.00 e la apertura delle buste amministrative è stata prevista in data 17/03/2022 9.30;
- nelle giornate del 18/03/2022, 24/03/2022 si sono tenute le sedute di apertura delle buste amministrative, nel corso delle quali sono state disposte le ammissioni delle ditte la cui documentazione amministrativa è risultata regolarmente trasmessa e alla ammissione con riserva delle ditte nei confronti delle quali è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio;
- nella seduta del 14/04/2022 si è proceduto alla verifica della documentazione di soccorso istruttorio e all'esito il RUP ha disposto il provvedimento di ammissione ed esclusione;
- con determina dell'Amministratore Unico del 06/04/2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

-Dott.ssa Lydia Romano- Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente;

fy
ee
va


- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro;
- Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro.

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante.

- in data 06/05/2022 si è riunita per la prima seduta la Commissione giudicatrice nella sua composizione alla presenza di: Dott.ssa Lydia Romano– Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro; Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro rilevando in particolare che la ditta SEDA SPA CON SOCIO UNICO non viene ammessa al prosieguo della gara per i lotti n.12 e n.17;
- Inoltre sempre in data 06/05/2022 il RUP dà atto che per mero errore di trascrizione la tabella riportata a fine verbale della seduta del 14/04/2022 e replicata sopra non conteneva per la Ditta ABBOTT l'indicazione del lotto n.9 di partecipazione, per il quale invece risultava correttamente depositata tutta la documentazione amministrativa in tutte le precedenti fasi di gara, come rilevato nei verbali delle relative sedute e come risulta da un'ulteriore verifica a conferma eseguita in data 6/05/2022 durante la seduta di gara. Pertanto la mancata trascrizione in tabella del riferimento al lotto n.9 della ditta ABBOTT è ricondotta ad un mero errore di trascrizione.
- in data 17/06/2022 alle ore 14.15 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero, la Commissione giudicatrice per la chiusura della fase tecnica e la conseguente apertura delle offerte economiche. Tuttavia a causa di una anomalia della piattaforma l'attività è stata sospesa non riuscendo ad accedere alla documentazione di offerta economica.

TANTO PREMESSO

Il Presidente dà atto che in data odierna 15/07/2022 alle ore 12.10 si è regolarmente costituita la Commissione alla presenza di tutti i componenti unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che

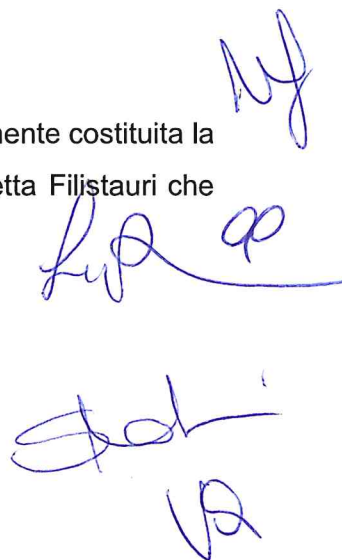

svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Carolina Cinesi e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero scarl anche in qualità di testimoni.

Si dà atto che la Dott.ssa Lydia Romano e la Dott.ssa Serena Natalini sono fisicamente presenti presso i locali di PuntoZero Scarl mentre la Dott. ssa Benedetta Enrico garantisce la presenza mediante modalità di videoconferenza di Google Meet attraverso la quale segue in tempo reale le operazioni su piattaforma Net4Market e interagisce con il resto dei presenti suindicati; la Dott.ssa Enrico procederà alla sottoscrizione del verbale mediante firma digitale apposta sul verbale vidimato e sottoscritto in alla presenza dalla Commissione, dal Segretario Verbalizzante e dalle due testimoni .


La seduta si svolge, ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte nonché l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione procede alla chiusura della fase tecnica e alla successiva apertura delle offerte economiche riepilogando le attività come segue.

Si dà atto che è stato necessario attivare il supporto della piattaforma Net4Market per la rimozione di n.2 messaggi di allerta che si sono riscontrati in corrispondenza della offerta delle ditte Cook Srl e New Tech Srl, nonostante l'apparente correttezza e corrispondenza del tipo di file alle prescrizioni della normativa di gara.

La piattaforma procede alla rimozione della anomalia alle ore 13.10 (come da email allegato 1).



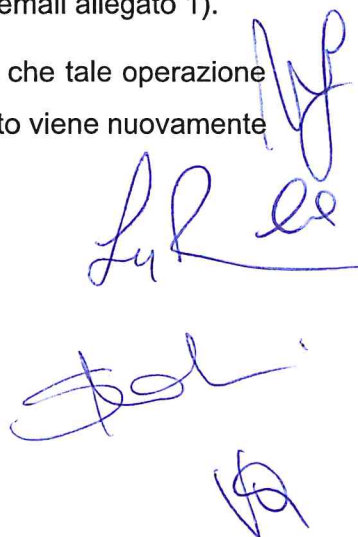


Si procede alla elaborazione delle graduatorie per lotto constatando tuttavia che tale operazione non consente di visualizzare niente all'interno della piattaforma. A questo punto viene nuovamente contattata l'assistenza Net4Market (come da mail allegato 2).



Nonostante l'attesa (fino alle ore 14.10), l'assistenza Net4Market non riscontra tempestivamente la richiesta di supporto e non fornisce, nonostante le ripetute chiamate, alcuna informazione circa le tempistiche di evasione, pertanto il Presidente della Commissione decide di sospendere le attività e definire altra data utile per la estrazione delle graduatorie finali.

L'attività si chiude alle ore 14.15.

Il verbale confermato e sottoscritto come sopra indicato dai seguenti:

- Dott.ssa Lydia Romano– con funzioni di Presidente 
- Dott.ssa Serena Natalini – in qualità di membro 
- Dott.ssa Benedetta Enrico – in qualità di membro FIRMA DIGITALMENTE
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Carolina Cinesi- collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 

Re: gara regionale stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CODICE DI GARA ANAC 8096887 prot. pr-002 stentvasbil

1 messaggio

clienti@net4market.com <clienti@net4market.com>
A: Nicoletta Filistauri <nicoletta.filistauri@puntozeroscarl.it>
Cc: CLIENTI <clienti@net4market.com>

15 luglio 2022 13:09

Buongiorno,

si comunica di aver provveduto a sanare le offerte in alert, come da richiesta.

Si precisa che l'alert rilevato da sistema sull'offerta della ditta Cook Italia era dovuto alla presenza del punto per la separazione delle migliaia.

Cordiali saluti

Assistenza clienti
T. +39 0372 080709
clienti@net4market.com
www.net4market.com

net 4 market

Net4market - CSAméd s.r.l.
[Corso G. Matteotti 15, 26100 Cremona](#)
T. +39 0372 801730 | Fax +39 0372 801740

C.F. e P.IVA 02362600344
Registro imprese di Cremona: 02362600344
REA: 171667 | Cap. sociale: 50.000 Euro i.v.
Il 15/07/2022 13:00, Nicoletta Filistauri ha scritto:

Si richiede con la massima urgenza di sbloccare l'errore bloccante riferito all'offerta economica della Ditta Cook e New Tech per la gara oggetto che nonostante l'apparente correttezza del formato del file di offerta risultano "bloccate" da messaggio di allerta e non potrebbero essere inserite l'offerta nelle relative graduatorie.
Grazie
--

.0 puntozero
LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

Nicoletta Filistauri
Responsabile Unico del Procedimento di gara
Centrale Regionale Acquisti in Sanità
Tel. +39 075 24291
Mobile +39 331.2358214

Punto Zero Scarl




www.puntozeroscarl.it

[Handwritten signatures in blue ink]

FAI UNA SCELTA ECOLOGICA - NON STAMPARE QUESTA E-MAIL SE NON È NECESSARIO

Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati, contiene informazioni di natura professionale attinenti l'attività lavorativa, riservate esclusivamente al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Informazioni aggiuntive nella sezione ****Privacy**** del sito internet: www.puntozeroscarl.it

According to the Italian law D.Lgs. 196/2003 and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council it is specified that this message, accompanied by any attachments, contains information of a professional nature relating to the work activity reserved exclusively for the indicated recipient (s). Please refrain from making: unauthorized forwarding, copies, distributions and disclosures of this message and any attachments. In the event of incorrect delivery, we kindly ask you to immediately notify the sender and to delete this message and any attachments. Additional information in the **** Privacy **** section of the website: www.puntozeroscarl.it



gara regionale stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CODICE DI GARA ANAC 8096887 prot. pr-002 stentvasbil

1 messaggio

Nicoletta Filistauri <nicoletta.filistauri@puntozeroscarl.it>

15 luglio 2022 13:19

A: CLIENTI <clienti@net4market.com>

Cc: Roberto Americioni <roberto.americioni@puntozeroscarl.it>

si richiede di intervenire con la massima urgenza in quanto pur prendendo atto che avete disposto la correzione delle anomalie segnalate al momento si constata che la funzione graduatoria non funziona per nessuno dei 27 lotti della gara. Si rende pertanto indispensabile un vostro tempestivo supporto chiarendo le ragioni del mancato funzionamento in considerazione anche dei disagi che stiamo sopportando nella delicatissima fase di gara. grazie.

--



Nicoletta Filistauri

Responsabile Unico del Procedimento di gara

Centrale Regionale Acquisti in Sanità

Tel. +39 075 24291

Mobile +39 331.2358214

Punto Zero Scarl



www.puntozeroscarl.it


Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CODICE DI GARA ANAC 8096887

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 17/06/2022

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 23/04/2021 è stata indetta "Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di stent vascolari e biliari per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria" il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GU/S S82 - 210749-2021-IT del 28/04/2021 e sulla GURI (V° Serie Speciale) N. 52 del 07/05/2021:
 - da espletare mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n.50/2016 suddivisa in 27 lotti;
 - da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - della durata di mesi 48 mesi;
 - per un importo totale per l'intera durata pari ad € 6.822.848,00;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 30/04/2021 è stata disposta la rettifica della gara con conseguente variazione dei valori stimati regionali dell'intera procedura: il valore economico stimato per 12 mesi è stato rettificato ad € 1.705.712,00 (IVA esclusa); il valore economico stimato per 48 mesi è stato rettificato ad € 6.822.848,00 (IVA esclusa);
- entro i termini di scadenza per l'invio dell'istanza di partecipazione, hanno presentato istanza n. 16 Operatori Economici;
- in data 16/08/2021 il RUP, come da verbali del 09/06/2021, del 14/06/2021 e del 16/08/2021, dopo avere esaminato le istanze di partecipazione e la documentazione amministrativa connessa alle stesse, ha disposto con provvedimento del 16/08/2021 l'ammissione per n. 16 Operatori Economici i cui nominativi non vengono divulgati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), almeno fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- con Determinazione dell'Amministratore di PuntoZero s.c.ar.l. del 10/02/2022 è stato

- approvato il fascicolo di gara inviato alle ditte ammesse in data 14/02/2022 tramite piattaforma telematica;
- entro il termine assegnato sono stati riscontrati i chiarimenti da parte delle Ditte e che le risposte ai quesiti nonché ogni altro chiarimento spontaneo formulato dalla stazione Appaltante mediante la funzione "chiarimenti" all'interno della piattaforma di eprocurement sono acquisiti quale parte integrante a tutti gli effetti della documentazione di gara;
 - in data 16/03/2022 il RUP con comunicazione pubblicata nella sezione chiarimenti ha provveduto all'aggiornamento dell'importo del lotto n. 6 che risultava erroneamente riportato in piattaforma per un valore annuale pari ad euro 6.000,00 come risultante dalla documentazione di gara, con conseguente aggiornamento della scheda di offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma; ha precisato inoltre che per i concorrenti che avevano già depositato offerta comprensiva del lotto n.6 recante l'errato importo a base d'asta di euro 24.000 (data l'impossibilità di revocare l'offerta già depositata), in caso di ravvisata incertezza da parte della stazione appaltante circa l'esatto valore dell'offerta economica presentata, terrà conto anche di quanto inserito nel dettaglio di offerta economica per il solo lotto n.6 in discussione;
 - la scadenza delle offerte è stata prevista, da ultimo, tassativamente per il giorno 16/03/2022 ore 20.00 e la apertura delle buste amministrative è stata prevista in data 17/03/2022 9.30;
 - nelle giornate del 18/03/2022, 24/03/2022 si sono tenute le sedute di apertura delle buste amministrative, nel corso delle quali sono state disposte le ammissioni delle ditte la cui documentazione amministrativa è risultata regolarmente trasmessa e alla ammissione con riserva delle ditte nei confronti delle quali è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio;
 - nella seduta del 14/04/2022 si è proceduto alla verifica della documentazione di soccorso istruttorio e all'esito il RUP ha disposto il provvedimento di ammissione ed esclusione;
 - con determina dell'Amministratore Unico del 06/04/2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:

-Dott.ssa Lydia Romano– Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente;

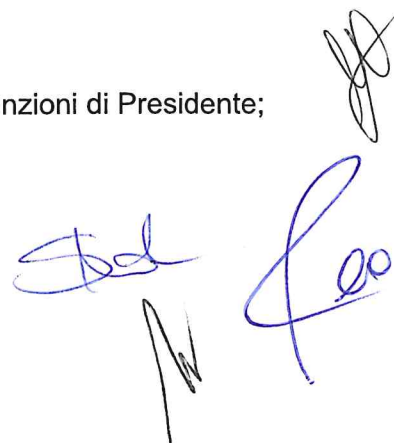

- Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro;
- Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro.


nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero quale segretario verbalizzante.

- in data 06/05/2022 si è riunita per la prima seduta la Commissione giudicatrice nella sua composizione alla presenza di: Dott.ssa Lydia Romano– Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; Dott.ssa Serena Natalini – Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di membro; Dott.ssa Benedetta Enrico – Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro rilevando in particolare che la ditta SEDA SPA CON SOCIO UNICO non viene ammessa al prosieguo della gara per i lotti n.12 e n.17;
- Inoltre sempre in data 06/05/2022 il RUP dà atto che per mero errore di trascrizione la tabella riportata a fine verbale della seduta del 14/04/2022 e replicata sopra non conteneva per la Ditta ABBOTT l'indicazione del lotto n.9 di partecipazione, per il quale invece risultava correttamente depositata tutta la documentazione amministrativa in tutte le precedenti fasi di gara, come rilevato nei verbali delle relative sedute e come risulta da un'ulteriore verifica a conferma eseguita in data 6/05/2022 durante la seduta di gara. Pertanto la mancata trascrizione in tabella del riferimento al lotto n.9 della ditta ABBOTT è ricondotta ad un mero errore di trascrizione.

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 17/06/2022 alle ore 14.15 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero, la Commissione giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Carolina Cinesi di Puntozero scarl.

La seduta si svolge, ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte nonché l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

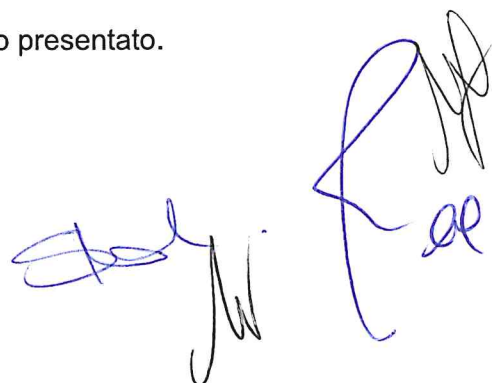

La Commissione procede con le attività di valutazione per il lotti ancora non esaminati :

LOTTO N. 25: Endoprotesi biliare in nitinol ricoperta in eptfe e FEP


- **BOSTON SCIENTIFIC SPA:** La Commissione constata la carenza di n.3 requisiti minimi richiesti come indicati nella tabella di dettaglio dei punteggi allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso (**Allegato 1**);. Per tali ragioni il prodotto viene giudicato dalla Commissione **NON IDONEO**.
- **ENDOVASCULAR SERVICE SRL:** La Commissione constata la carenza di n.3 requisiti minimi richiesti come indicati nella tabella di dettaglio dei punteggi allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso (**Allegato 1**). Per tali ragioni il prodotto viene giudicato dalla Commissione **NON IDONEO**
- **W.L.GORE & ASSOCIATI:** La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**.

LOTTO N. 26: Stent renale in cromo-cobalto L605 con struttura delle celle chiusa con elementi di connessione a doppia omega

- **NEOVASC SRL:** La Commissione constata la carenza di n. 4 requisiti minimi richiesti come riportato nella tabella di dettaglio dei punteggi allegata al presente verbale e parte integrante dello stesso (**Allegato 1**). Per tali ragioni il prodotto viene giudicato dalla Commissione **NON IDONEO**
- **NEW TECH SRL:** La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione dei requisiti migliorativi, con il seguente esito finale: **60,00**.

Conclusa la fase di valutazione la Commissione verifica che tutti i concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento di 38 punti e dà atto che non sussistono offerte con punteggio inferiore a tale valore numerico.

La Commissione procede alla riparametrazione dei singoli punteggi per effetto delle disposizioni di cui al par. 12.3 della lettera di invito *"Se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il*

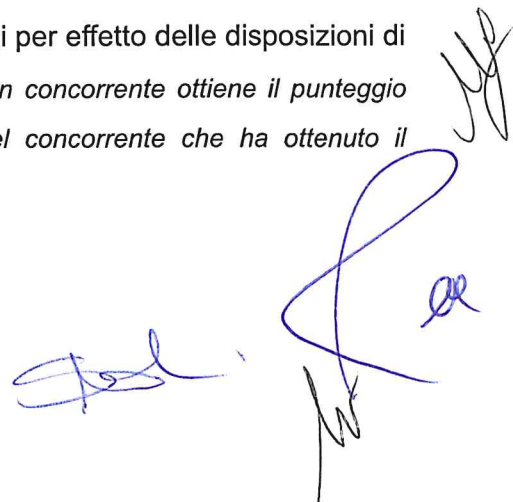

punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (70), il punteggio conseguito verrà riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa e a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, su un singolo criterio, il massimo punteggio previsto per lo stesso e, alle altre offerte, un punteggio proporzionale decrescente".

Stante quanto precede i punteggi vengono riparametrati e si inseriscono sul sistema Net4Market i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e si dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti come riportato nelle griglie allegate al presente verbale e parte integrante di esso.

Si tenta di procedere alla chiusura telematica della fase tecnica ma la piattaforma Net4Market nonostante i reiterati tentativi suggeriti dalla assistenza telefonica non riesce a fare accedere alla documentazione di offerta economica. Per tale ragione si deve sospendere la seduta e rinviare ad un momento successivo.

Si allegano al presente verbale le schede riepilogative delle valutazioni svolte dalla Commissione giudicatrice delle offerte tecniche sopra valutate, per costituirne parte integrante e sostanziale (come peraltro richiamate negli allegati). Alle ore 15.30 la Commissione sospende le attività e rinvia per il prosieguo delle operazioni alla successiva seduta di gara.

La Commissione dà atto che i seguenti lotti sono andati deserti in quanto privi di offerte valide/offerte idonee: lotto 11, lotto 16, lotto 23.

Il verbale confermato e sottoscritto viene sottoscritto come segue.

- Dott.ssa Lydia Romano– con funzioni di Presidente _____
- Dott.ssa Serena Natalini – in qualità di membro _____
- Dott.ssa Benedetta Enrico – in qualità di membro _____
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante _____
- Dott.ssa Carolina Cinesi- collaboratore e testimone _____

LOTTO N. 25: Endoprotesi biliare in nitinol ricoperta in epfe e FEP

REQUISITI MINIMI

Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)

Endoprotesi biliare;

in nitinol;

in epfe e FEP con barriera per mantenere la pervietà del vaso;

provvista di alette di ancoraggio completamente ricoperte in epfe per prevenire la migrazione dello stent;

e disponibile nella versione con i fori di drenaggio attorno alla protesi nelle misure $\Phi 10$ di diametro e $6-10$ cm di lunghezza;

con alette di $4-6,0$ cm;

la versione rimovibile del dispositivo e senza fori e ha un diametro di $\Phi 6$ mm e un

BOSTON SCIENTIFIC SPA				ENDOVASCULAR SERVICE SRL				W.L.GORE & ASSOCIATI			
X				X				X			
X				X				X			
X				X				X			
NON HA IL RIVESTIMENTO RICHIESTO				NON HA IL RIVESTIMENTO RICHIESTO				X			
NON PRESENTI ALETTE				NON PRESENTI ALETTE				X			
NON PRESENTE				NON PRESENTE				X			
X				NON DICHIARATO				X			
NON IDONEO				NON IDONEO				NON IDONEO			
BOSTON SCIENTIFIC SPA				ENDOVASCULAR SERVICE SRL				W.L.GORE & ASSOCIATI			
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
#DIV/9/				#DIV/9/				10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
#DIV/9/	#DIV/9/			#DIV/9/	#DIV/9/			0	0	0	0
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
#DIV/9/	#DIV/9/			#DIV/9/	#DIV/9/			0	0	0	0
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
#DIV/9/				#DIV/9/				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
#DIV/9/				#DIV/9/				20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
#DIV/9/				#DIV/9/				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
#DIV/0/				#DIV/0/				60,00	1	1	1

Handwritten signatures: "h", "up a", and "ash".

Pusha

All. 2

LOTTO N. 26: Stent renale in cromo-cobalto L605 con struttura delle celle chiusa con elementi di connessione a doppia omega

REQUISITI MINIMI
 Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
 stent renale in cromo-cobalto L605;
 con struttura delle celle chiusa con elementi di connessione a doppia omega;
 configurazione nei diametri di 4,0,5,0,6,0,7,0 mm;
 configurazione nelle lunghezze 12,15,18,24 mm;
 disponibile con delivery nella configurazione OTW su guida 0,018 e delivery monorail su guida 0,14.

NEOVASC SRL	NEW TECH SRL
X	X
STENT IN ACCIAIO NON IN CROMO COBALTO	X
NON DICHIARATO	X
MANCA IL DIAMETRO 4	X
MANCA NO LE LUNGHEZZE RICHIESTE	X
NON PRESENTE LO 0,14	X
NON IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!				10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			VAI	VA	VMAX		1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	#DIV/0!				0	VAI	VA	VMAX
			VAI	VA	VMAX		0	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	#DIV/0!				0	VAI	VA	VMAX
			ROMANO	ENRICO	NATALINI		0	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			ROMANO	ENRICO	NATALINI		1	1	1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!				20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			ROMANO	ENRICO	NATALINI		1	1	1
5. Navigabilità	15	#DIV/0!				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			ROMANO	ENRICO	NATALINI		1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!				60,00			

up

fa

Bruck

Sal.

LOTTO N. 1: Stent autoespandibile in fili di nitinol intrecciati
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent autoespandibile;
in fili di nitinol intrecciati per piccoli vasi a basso profilo;
compatibile con guida 0,018" e 0,014";
diametri da 4.5 a 7.5 mm;
lunghezze fino a 200 mm.
Sub lotto: lunghezze da 20 a 200 mm.

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
x
x
x
x
x
x
x

			ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL		
REQUISITI PREFERENZIALI					
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
3. Precisione durante il rilascio	15	15	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
5. Navigabilità	15	15	1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO N. 2: Stent in e Ptfe e acciaio premontato su pallone di Ptfe e legame in eparina
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent in ePtfe e acciaio;
premontato su pallone di Ptfe;
legame in eparina;
range di diametri da 5 mm a 11 mm con possibilità di sovradilatazione fino a 16 mm.
Sub lotti: Lunghezze 15/20 mm circa
Sub lotti: Lunghezze 30/40 mm circa
Sub lotti: Lunghezze 60/70 mm circa

W.L.GORE & ASSOCIATI					
					X
					x
					x
					x
					x
					x
					x
					x

W.L.GORE & ASSOCIATI					
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	8	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
3. Precisione durante il rilascio	15	15	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
5. Navigabilità	15	15	1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		68,00			

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 70

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO N. 3: Endoprotesi in nitinolo ricoperta in ePTFE composta da un filo di nitinolo unico. Marker radiopachi
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
endoprotesi in nitinolo;
ricoperta in ePTFE;
composta da un filo di nitinolo unico, senza punti di connessione;
superficie interna ricoperta di eparina;
marker radiopachi con lunghezze da 2,5 a 25 cm.
Sub lotti: Lunghezze 2,5-5 cm
Sub lotti: Lunghezze 10 cm
Sub lotti: Lunghezze 15 cm
Sub lotti: Lunghezze 25 cm.

W.L.GORE & ASSOCIATI	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

		W.L.GORE & ASSOCIATI			
REQUISITI PREFERENZIALI					
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
3. Precisione durante il rilascio	15	15	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
5. Navigabilità	15	15	1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE RIPARAMETRATO

70

[Handwritten signatures and initials]

REQUISITI PREFERENZIALI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima
3. Precisione durante il rilascio
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione
5. Navigabilità
TOTALE PUNTEGGIO

W.L.GORE & ASSOCIATI			
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
0	#DIV/0!	0	0
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2	1	4	4
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
62,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70
--------------------------------	----

Handwritten signatures in black and blue ink.





LOTTO N. 5: Stent auto-espandibile in Nitinol a rilascio di farmaco Facilitax
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
Stent auto-espandibile,
in Nitinol;
a rilascio di farmaco Facilitax;
sistema di rilascio trascurabile compatibile con introduttore da 6 Fr;
presenza di 4 marker d'oro posti all'estremità dello stent;
diametri dello stent: da 3 mm a 8 mm;
lunghezza dello stent: da 4 cm a 14 cm

REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	BOSTON SCIENTIFIC SFA			COOK ITALIA SRL			NEOVASC SRL		
			ROMANO	ENRICO	NATALINI	ROMANO	ENRICO	NATALINI	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Stent clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!				10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA		
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggressive superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX	0	0	0	0	VAI	VA
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggressive superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	2	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX	0	0	0	0	VAI	VA
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	ROMANO	ENRICO
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!	ROMANO	ENRICO	NATALINI	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	ROMANO	ENRICO
5. Navigabilità	15	#DIV/0!	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	ROMANO	ENRICO
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!				60,00				#DIV/0!	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large, stylized signature.
 - Middle right: The initials "Le".
 - Bottom left: The signature "Pardes".
 - Bottom right: The signature "Joh".

LOTTO N. 6: Stesi a colle aperti, premontati su pallone, in acetale OTW
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stesi a colle aperti
premontati su pallone
in acetale OTW
compatibile con guida da 0.035" e 0.018"
pallone anticomprimente con doppio manico telescopico
profondità del pallone a DOG-BONDING
lunghezza dello stelo: 80 e 133 cm
diámetro dello stelo: da 3 mm a 10 mm
lunghezza dello stelo: da 12 mm a 16 mm

		NEW BOSTON				COOK ITALIA SRL				NEW TECH SRL				
		BOSTON SCIENTIFIC SPA												
REQUISITI PREFERENZIALI		PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!					4	PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
								0,0	0,0	0,0		1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di manovre aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	#DIV/0!		VAI	VA	VMAX	0	0	0	1	8	1	1	1
								VAI	VA	VMAX		VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di manovre aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	2	#DIV/0!		VAI	VA	VMAX	0	0	0	0	0	0	0	0
								VAI	VA	VMAX		VAI	VA	VMAX
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!					15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	12	PRF CHE ADEGUATA	PRF CHE ADEGUATA	PRF CHE ADEGUATA
								1	1	1		0,0	0,0	0,0
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!					16	PRF CHE ADEGUATA	PRF CHE ADEGUATA	PRF CHE ADEGUATA	16	PRF CHE ADEGUATA	PRF CHE ADEGUATA	PRF CHE ADEGUATA
								0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5. Navigabilità	15	#DIV/0!					15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
								1	1	1		1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!					50,00				61,88			
						TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				
						57,37				70				

LOTTO N. 7: Stent carotideo autoespandibile con micromaglia a doppio strato in nitinol a celle chiuse (375-500 micron)
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent carotideo autoespandibile;
con micromaglia a doppio strato in nitinol;
a celle chiuse (375-500 micron);
con sistema di rilascio che ne consenta la ricattura e riposizionamento;
compatibile con introduttori da 5 fr;
diametri da 5 a 10 mm.

GADA ITALIA SPA
X
X
X
X
X
X
X
X
IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI			GADA ITALIA SPA		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
3. Precisione durante il rilascio	15	15	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
5. Navigabilità	15	15	1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO N. 8: Stent autoespandibile carotideo in nitinol a tronco conico e tubolare
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent autoespandibile carotideo;
in nitinol;
a tronco conico e tubolare;
menorail;
guida 014";
con disegno ad anelli corrugati e connessioni a ponte;
diametri stent:
distale - prossimale di 6-8 mm e di 7-9mm e 8-10mm;
tubolari da 7 a 10 mm;
Lunghezze di 20, 30, 40 mm;
sistema di rilascio a singola mano

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	ANTONIO PELLECCIA SRL
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	NON DICHIARATO
X	X
X	VEDI VERBALE 09/06/2022
X	VEDI VERBALE 09/06/2022
X	VEDI VERBALE 09/06/2022
X	X
IDONEO	NON IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL			ANTONIO PELLECCIA SRL		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!
			1	1	1	
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX	#DIV/0!
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	0	0	0	#DIV/0!
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!
			1	1	1	
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!
			1	1	1	
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	#DIV/0!
			1	1	1	
TOTALE PUNTEGGIO		60,00				#DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70
---------------------------------------	-----------






LOTTO N. 9: Strati in nitinol autoespandibile con struttura a corone collegata da ponti
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
strati in nitinol autoespandibile,
con struttura a corone collegata da ponti,
lunghezza da 20 a 150 mm;
diametri da 5 a 10 mm;
catena di rilascio a controllo micrometrico;
tutti le misure compatibili con introduzione da 6 Fr.

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	BOSTON SCIENTIFIC SPA	VIOLATECH SRL
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X

		BIOVET			BIOVET			BIOVET							
		ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL			BOSTON SCIENTIFIC SPA			VIOLATECH SRL							
REQUISITI PREFERENZIALI		PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	4	ADEGUATA	ADEGUATA	ADEGUATA	8	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	
			1	1	1	0,5		0,5	0,5	0,8		0,8	0,8		
2A. Gamma di lunghezze. Numero di misure aggiuntive superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime			PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
			4	0	0	0	2	0	0	0	2	8	1	2	2
2B. Gamma di diametri. Numero di misure aggiuntive superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima			PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
			2	0	0	0	2	2	1	2	2	1	0,5	1	2
3. Precisione durante il rilascio	15	15	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
					OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA				PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	ADEGUATA	ADEGUATA
					1	1	1	12	0,8	0,8	0,8	9	0,6	0,6	0,6
4. Flessibilit�, conformabilit� e resistenza alla compressione	20	20	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
					OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA				PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	ADEGUATA	ADEGUATA
					1	1	1	16	0,8	0,8	0,8	12	0,6	0,6	0,6
5. Navigabilit�	15	15	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
					OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA				OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA
					1	1	1	15	1	1	1	12	0,8	0,8	0,8
TOTALE PUNTEGGIO			60,00					51,00				50,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 70

59,5

58,33





[Handwritten signatures and initials]

LOTTO N. 10: Stent carotideo metallico autoespandibile costituito da mono filamenti in lega metallica in Elgiloy intrecciati
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent carotideo metallico autoespandibile;
costituito da mono filamenti in lega metallica;
in Elgiloy;
intrecciati in una configurazione tubolare a maglia;
a celle chiuse;
montato su sistema di rilascio coassiale a basso profilo;
monorail su filoguida 0,014";
misure: diametro stent da 5 a 9 mm

BOSTON SCIENTIFIC SPA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IDONEO					
BOSTON SCIENTIFIC SPA					
REQUISITI PREFERENZIALI					
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70
---------------------------------------	-----------

LOTTO N. 13: Stent in acciaio 316L premontato su pallone in nylon minimamente compliant
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent in acciaio 316L;
premontato su pallone in nylon minimamente compliant;
presenta markers radiopachi in Tantalio sullo stent;
posizionati alle due estremità;
diametri da 5 a 10mm;
lunghezze: 12mm (fino ai diametri da 7mm) e 17, 27, 37, 57mm (tutti i diametri);
compatibili con introduttore 6 - (fino al diametro 8mm, lunghezza 57mm) e 7 Fr;

MEDTRONIC ITALIA SPA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IDONEO

MEDTRONIC ITALIA SPA					
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
			VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	#DIV/0!	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
			ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
			ROMANO	ENRICO	NATALINI
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
			ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
			ROMANO	ENRICO	NATALINI
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70
---------------------------------------	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 15: Stent in Nitinolo autoespandibile a celle aperte, disponibile nella forme cilindrica o rastremata, con forma a collo di bottiglia.
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent in Nitinolo autoespandibile;
a celle aperte;
disponibile nella forme cilindrica o rastremata;
con forma a collo di bottiglia, particolarmente indicato per la biforcazione della CCA con ICA;
ottima visibilità grazie ai markers prossimali e distali sullo stent, oltre che sul catetere di rilascio;
diametri da 6 a 10mm;
lunghezze da 20 a 60mm;
per lo stent rastremato (con forma a "collo di bottiglia") diametri 6X8 e 7X10 mm, lunghezze 30 o 40mm;
sistema di rilascio a semplice pull-back.

MEDTRONIC ITALIA SPA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MEDTRONIC ITALIA SPA					
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70
---------------------------------------	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 17: Stent autoespandibile in Nitinol con sistema di rilascio è micrometrico a rotella, OTW (0.018"), triassiale compatibile con introduttore 4F. Rivestimento in Carburo di Silicio Amorfo.

REQUISITI MINIMI

Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
 stent autoespandibile;
 in Nitinol;
 con sistema di rilascio è micrometrico a rotella;
 OTW (0.018");
 triassiale compatibile con introduttore 4F per l'intera gamma di misure;
 rivestimento in Carburo di Silicio Amorfo
 strut sottili da 140 micrometri;
 lunghezze dello stent da 20 a 200 mm;
 con diametri da 4.0 a 7.0 mm;
 lunghezza utile 90 e 135 cm.

NEW TECH SRL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IDONEO

NEW TECH SRL

REQUISITI PREFERENZIALI

	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	#DIV/0!	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
3. Precisione durante il rilascio	15	15	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
5. Navigabilità	15	15	1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

70

LOTTO N. 18: Stent in CoCr espandibile a palloncino Sistema di rilascio RX compatibile con fili 0.014"
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent in CoCr espandibile;
a palloncino;
sistema di rilascio RX compatibile con fili 0.014";
corona prossimale in Oro;
rivestimento in Carburio di Silicio Amorfo;
lunghezze 12, 15, 19 mm;
compatibilità 4F per diametri 4.5 e 5.00 mm (6.0 e 7.0 mm compatibili 5F);
spessore di strut da 120/140 micrometri;

NEOVASC SRL	NEW TECH SRL
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
NON HA IL DIAMETRO 4.5	X
NON HA LO SPESSORE RICHIESTO DELLA MAGLIA	X
NON IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	NEOVASC SRL					NEW TECH SRL			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!				10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX
							0	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX
							0	0	0
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!				20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
5. Navigabilità	15	#DIV/0!				15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!				60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REQUISITI PREFERENZIALI	
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	
3. Precisione durante il rilascio	
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	
5. Navigabilità	
TOTALE PUNTEGGIO	

VIOLATECH SRL			
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
0	#DIV/0!	0	0
PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX
0	#DIV/0!	0	0
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
	1	1	1
60,00			

Handwritten signatures in black and blue ink.

LOTTO N. 20: Stent autoespandibile in nitinol ricoperto in ePTFE. Struttura dello stent con corone indipendenti disposte con tecnica picco-valle.
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent autoespandibile;
in nitinol;
ricoperto in ePTFE;
struttura dello stent con corone indipendenti disposte con tecnica picco-valle e connessioni tra le corone alternate;
porzione prossimale e distale scoperta per circa 1,5 cm;
ePTFE modificato elettronicamente per aumentare la resistenza multidirezionale;
sistema di rilascio elemento idrofilico con tecnica pull-back associata a sistema anti jumping e punta atraumatica;
diametri da 6 a 9mm lunghezza da 40 a 80mm;
compatibilità con guida 0.035" ed introduttori 9F4

BARD SRL	VIOLATECH SRL
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

REQUISITI PREFERENZIALI		BARD SRL				VIOLATECH SRL			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	8	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	PIU' CHE ADEGUATA	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			0,8	0,8	0,8		1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	8	VAI	VA	VMAX	2	VAI	VA	VMAX
			1	4	4		0,25	1	4
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	2	VAI	VA	VMAX	0,5	VAI	VA	VMAX
			1	4	4		0,25	1	4
3. Precisione durante il rilascio	15	9	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			ADEGUATA	ADEGUATA	ADEGUATA		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	8	ROMANO	ENRICO	NATALINI	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
5. Navigabilità	15	9	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			ADEGUATA	ADEGUATA	ADEGUATA		OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
TOTALE PUNTEGGIO		44,00				62,50			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	49,28
--------------------------------	-------

70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 22: Stent carotideo auto-espandibile in Nitinol ricoperto da una retina in PET (Polietilene tereftalato)
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent carotideo auto-espandibile;
in Nitinol;
ricoperto da una retina in PET (Polietilene tereftalato);
è composto da un manipolo di rilascio funzionante con tecnica "pullback";
con sistema di ritenzione che annulla il salto in avanti dello Stent al momento del rilascio;
diametri dello Stent da 6 a 10mm;
lunghezza da 20 a 60 mm;
diametro esterno sistema: 6 Fr (2.1 mm);
compatibilità Catetere Guida: 8Fr (2.7 mm);
compatibilità Filo Guida: 0,014"

NEW TECH SRL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IDONEO					
NEW TECH SRL					
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70
---------------------------------------	-----------

LOTTO N. 24: Endoprotesi vascolari per procedura TIPS auto espandibile, nitinol e PTFE
REQUISITI MINIMI
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
endoprotesi vascolari per procedura TIPS auto espandibile;
nitinol;
PTFE;
parte scoperta per versante portale;
parte coperta per il tramite intraepatico;
lunghezza da 4cm a 8 cm;
diametro 8/10

W.I.GORE & ASSOCIATI	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
IDONEO	

		W.I.GORE & ASSOCIATI			
REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	0	VAI	VA	VMAX
			#DIV/0!	0	0
3. Precisione durante il rilascio	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	20	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
5. Navigabilità	15	15	ROMANO	ENRICO	NATALINI
			OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
			1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70
---------------------------------------	-----------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO N. 25: Endoprotesi bilare in nitinol ricoperta in eptfe e FEP													
REQUISITI MINIMI													
Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)													
endoprotesi bilare:													
in nitinol:													
ricoperta in eptfe e FEP come barriera per mantenere la pervietà del vaso.													
provista di alette di ancoraggio completamente ricoperte in eptfe per prevenire la migrazione dello stent.													
e disponibile nella versione con i fori di drenaggio attorno alla protei nelle misure 8-10 di diametro e 6-8-10 cm di lunghezza.													
la versione rimovibile del dispositivo e' senza fori e ha un diametro di 8 e 10 mm e una lunghezza di 4-6-8-10 cm													

LOTTO N. 26: Stent renale in cromo-cobalto L605 con struttura delle celle chiusa con elementi di connessione a doppia omega

REQUISITI MINIMI

Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)

stent renale in cromo-cobalto L605;

con struttura delle celle chiusa con elementi di connessione a doppia omega;

configurazione nei diametri di 4,0,5,0,6,0,7,0 mm;

configurazione nelle lunghezze 12,15,18,24 mm;

disponibile con delivery nella configurazione OTW su guida 0,018 e delivery monorail su guida 0,14.

NEOVASC SRL	NEW TECH SRL
X	X
STENT IN ACCIAIO NON IN CROMO COBALTO	X
NON DICHIARATO	X
MANCA IL DIAMETRO 4	X
MANCA NO LE LUNGHEZZE RICHIESTE	X
NON PRESENTE LO 0,14	X
NON IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ROMANO	ENRICO	NATALINI
1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate	10	#DIV/0!				10	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime	8	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX
2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima	2	#DIV/0!	VAI	VA	VMAX	0	VAI	VA	VMAX
3. Precisione durante il rilascio	15	#DIV/0!	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione	20	#DIV/0!	ROMANO	ENRICO	NATALINI	20	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
5. Navigabilità	15	#DIV/0!	ROMANO	ENRICO	NATALINI	15	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA
							1	1	1
TOTALE PUNTEGGIO		#DIV/0!				60,00			

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

70

MP

ee

Burdel

Josh

LOTTO N. 27: Stent Vascolare Ricoperto Autoespandibile in Nitinol, interamente incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE con lume interno impregnato al Carbonio

REQUISITI MINIMI

Caratteristiche generali dei prodotti (Capitolato tecnico art. 1)
stent vascolare ricoperto autoespandibile;
in Nitinol;
interamente incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE;
con lume interno impregnato al Carbonio;
marker radiopachi in Tantalio su ciascuna estremità dello stent;
disponibile in versione retta e fletta (Porzione distale svasata di 3 mm);
diametri dello stent da 6 a 10 mm;
lunghezze da 30 a 100 mm;
sistema di Rilascio Triassiale OTW con guaina esterna di supporto;
compatibilità con filo guida da 0,035" e introduttore da 8 e 9 Fr a seconda delle dimensioni.

BARD SRL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IDONEO

BARD SRL

REQUISITI PREFERENZIALI

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

1. Studi clinici su riviste scientifiche dedicate

10

10

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

VAI

VA

VMAX

2A. Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche minime

8

0

#DIV/0!

0

0

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

VAI

VA

VMAX

2B. Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, superiori a quanto indicato nelle caratteristiche di minima

2

0

#DIV/0!

0

0

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

3. Precisione durante il rilascio

15

15

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

4. Flessibilità, conformabilità e resistenza alla compressione

20

20

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

PUNTEGGIO ASSEGNABILE

PUNTEGGIO CONSEGUITO

ROMANO

ENRICO

NATALINI

5. Navigabilità

15

15

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

1

1

1

TOTALE PUNTEGGIO

60,00

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

70